
WHALETEQ Test Solutions for Medical Device Manufacturers

Compliance

SECG 5.0 AIO
標準輔助軟體

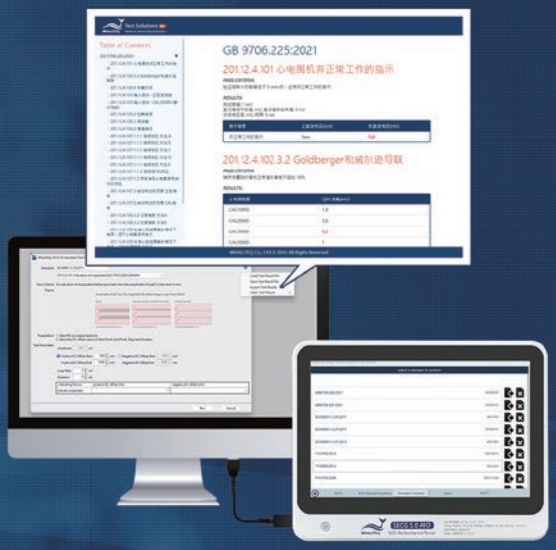

只需依照軟體引導的步驟操作，即可執行標準要求的合規測試

- 可儲存和載入測試設定 -
  儲存常用的測試參數設定，並同時暫存測試結果，無需擔憂突發狀況中斷測試，
  並避免重複手動設置導致的人為失誤

- 匯整測試結果為 HTML 格式報告 -
  匯出每一次測試結果為 HTML 格式報告，建立可追溯的測試歷程，
  方便跨單位追蹤和稽核審查

- 彈性設定參數* - 支援自定義參數數值，協助研發人員測試邊界值及驗證客製規格


*備註：僅 GB 9706.225、GB 9706.227、YY 9706.247 的 Premium 版本支援此功能。

Medical Standard Coverage

IEC 60601-2-25 | IEC 60601-2-27 | IEC 60601-2-47 | GB 9706.225 | GB 9706.227 | YY 9706.247

通過標準定義及圖示
無需查找、一目了然

儲存及載入測試設定檔
無需重複設定，並可暫存測試結果

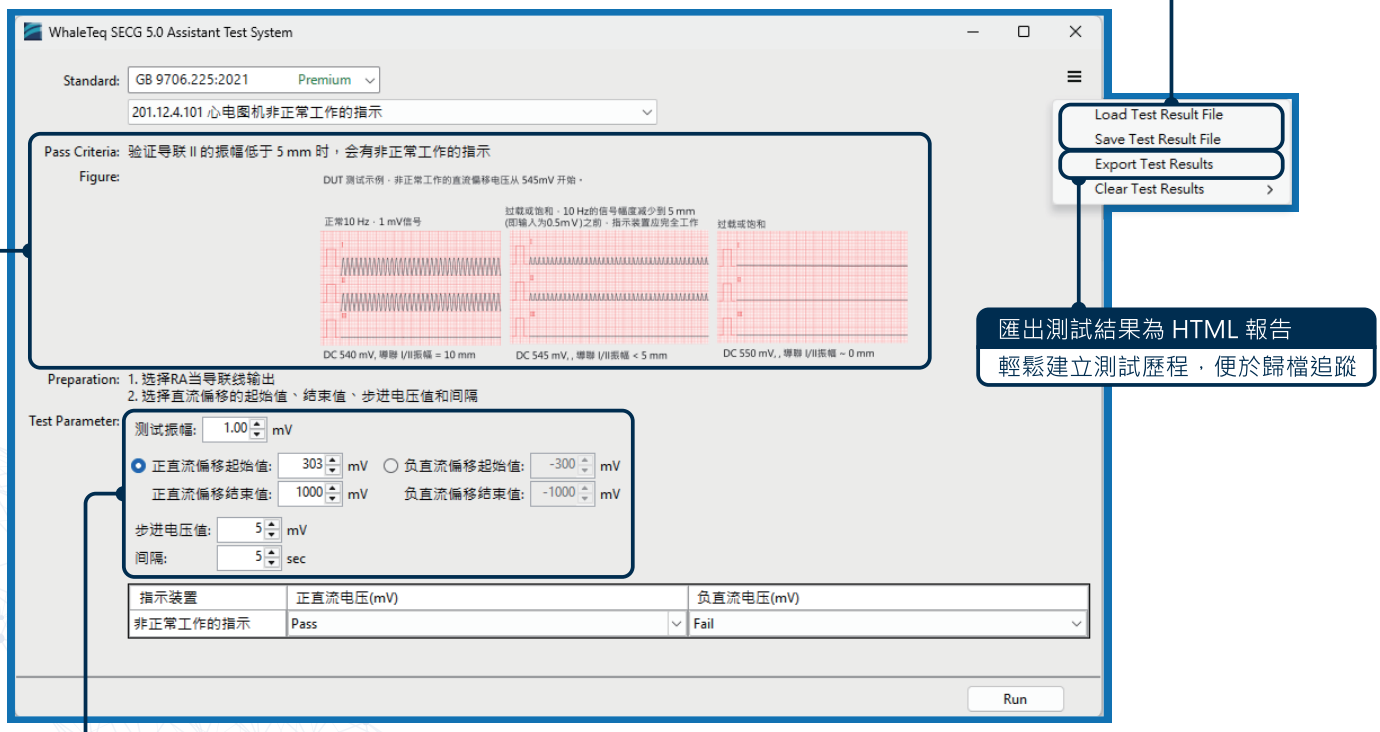

匯出測試結果為 HTML 報告
輕鬆建立測試歷程，便於歸檔追蹤

可調整參數數值*
方便測試邊界值及自定義規格驗證

*備註：僅 GB 9706.225、GB 9706.227、YY 9706.247 的 Premium 版本支援。

功能比較表

	Premium 版本	Basic 版本
適用情境	研發調試、邊界值驗證、標準合規驗證	標準合規驗證
測試參數調整	**可自由調整**	**固定預設值**
測試振幅（Amplitude）	範圍：±40mV	依標準規範定義，不可修改
直流偏移（DC Offset）	範圍：±1000mV	
起搏脈衝振幅（Pacing Pulse Amplitude）	範圍：±700mV	
其他法規標準參數	可依需求調整，如時間間隔、測試頻率等	
功能		
匯出測試結果	匯出為 HTML（*.html）檔	
載入測試設定檔	可快速載入先前儲存的測試參數設定	
儲存測試設定檔	可儲存自訂參數設定以重複使用	

訂購資訊

產品料號	產品敘述
HA0-SE0G001	醫療標準 IEC 60601-2-25:2011 性能測試輔助軟體（Basic 版，單機或外接電腦皆可使用）
HA0-SE0G002	醫療標準 IEC 60601-2-27:2011 性能測試輔助軟體（Basic 版，單機或外接電腦皆可使用）
HA0-SE0G003	醫療標準 IEC 60601-2-47:2012 性能測試輔助軟體（Basic 版，單機或外接電腦皆可使用）
HA0-SE0G014	醫療標準 GB 9706.225-2021 性能測試輔助軟體（Premium 版，可調整測試參數，需搭配電腦使用）
HA0-SE0G015	醫療標準 GB 9706.227-2021 性能測試輔助軟體（Premium 版，可調整測試參數，需搭配電腦使用）
HA0-SE0G016	醫療標準 YY 9706.247-2021 性能測試輔助軟體（Premium 版，可調整測試參數，需搭配電腦使用）

SECG 5.0 AIO
Standard Assistant Software
Scan for more information

www.whaleteq.com
service@whaleteq.com
8F., No. 125 Songjiang Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104474, Taiwan
+886-2-2517-6255
+886-2-2596-0702